



Pikaopas tiedonsiirtoon

ZOLL AED Plus defibrillaattori infrapunaportilla

Tarvittavat varusteet

PC seuraavat ohjelmistot asennettuina:

- RescueNet Code Review
(www.zolldata.com/rescuenet-code-review)
- Microsoft.Net Framework (Microsoft-päivityksistä tai www.zolldata.com/c-r-downloads)
- Infrapunaportti laitteesta tietokoneeseen

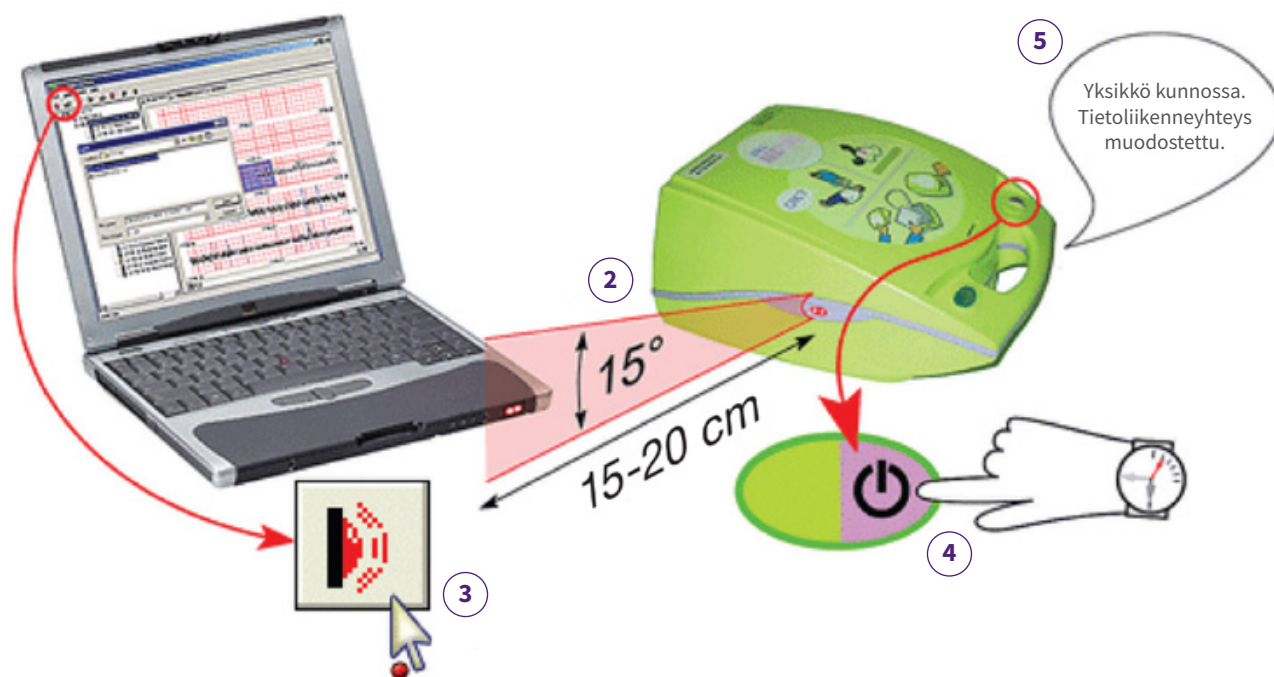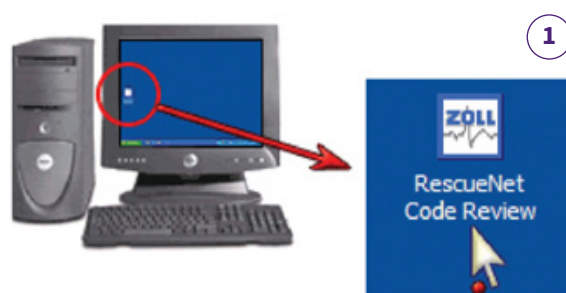

Ohjeistus

1. Avaa tietokoneella ohjelmisto **RescueNet Code Review**. Ohjelma avaa tyhjän sivun.
2. Aseta defibrillaattorin ja tietokoneen infrapunaportit vastakkain.
3. Klikkaa ohjelmassa **Upload Case from Infrared**.
4. Paina defibrillaattorin ON/OFF-painiketta 7-8 sekuntia.
5. Odota, kunnes defibrillaattori kertoo, että **Yksikkö kunnossa. Tietoliikenne yhteys muodostettu** (voi kestää jopa 20 s.).
6. **RescueNet Code Review** ohjelma näyttää koko tiedonsiirtoprosessin valintaikkunassa.
7. Paina File - Print - Case - Stripes - OK, jos haluat tulostaa tiedot.